

機械器具51 医療用嚙管及び体液誘導管

高度管理医療機器 ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル JMDNコード 10729400

生物由来製品 **メディカット LCV-UK キット**

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞


- 1.カテーテル本体（以下、カテーテル）留置後、エックス線撮影下でカテーテルが体内でループを描いたりしていないか、またカテーテルが目的部位に正しく留置されていることを確認すること。[ミスロッキングや Extravasation of fluids を防ぐため。]
- 2.ガイドワイヤ又はカテーテル等を挿入あるいは抜去する際、異常な抵抗を感じたら操作を中止し、エックス線撮影下でその原因を確認し、適切な処置を行うこと。[血管等を損傷するおそれがあるため。]
- 3.挿入具を介してガイドワイヤを挿入後、抵抗が強く容易に抜去できないときは、ガイドワイヤを無理に引張らず、挿入具とともに抜去すること。[ガイドワイヤを無理に引張ると、破損したり先端が切れて血管内に残るおそれがあるため。]
- 4.アルコールを含有する抗癌剤等を投与する場合、カテーテルの状態を観察し、カテーテルの交換を行うこと。[アルコール等含有薬剤の使用により、カテーテルの強度が低下し、カテーテルに損傷を与えて亀裂や破断の生じるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止
- 3.カテーテルと有機溶剤との接触は避けること。[アルコール含有消毒剤、ハイポアルコール等、及び脱脂等を目的とするアセトン等の有機溶剤に接触すると、強度が低下したり亀裂が生じるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

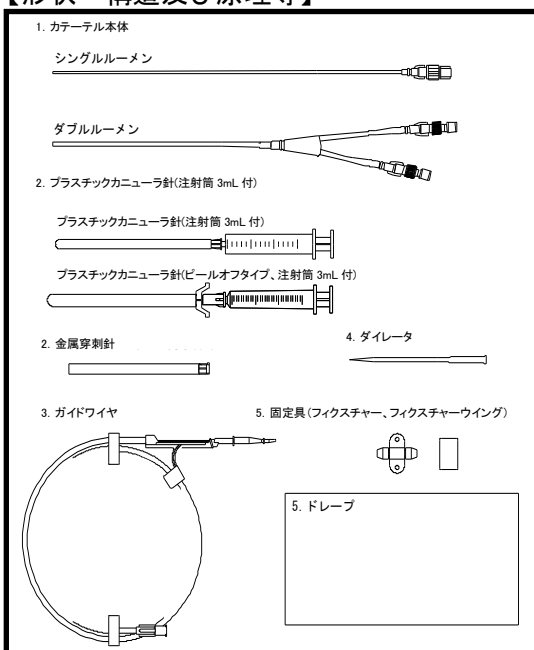

カテーテルにはシングルルーメンタイプ及びダブルルーメンタイプがあり、本品の使用法によりカニューラタイプ及びセルジンガータイプがある。

なお、カテーテル表面には抗血栓性を示すウロキナーゼがコーティングされており、このウロキナーゼはヒト尿由来である。組合せにより、同梱されない製品もある（同梱されている製品は、直接の包装に記載している）。

1.カテーテル本体

本品は、ポリウレタン製のカテーテルで、抗血栓性を有するウロキナーゼがコートしてあり、薬剤注入に用いる。

カテーテル外径

シングルルーメン	2.0mm (14G)	1.5mm (16G)	1.1mm (18G)	0.8mm (20G)
ダブルルーメン	2.0mm (14G)	1.5mm (16G)	1.1mm (18G)	

2.プラスチックカニューラ針(注射筒3mL付)、金属穿刺針

本品は、血管確保のための血管穿刺に用いるカニューラタイプ又はセルジンガータイプの2種類があり、金属穿刺針にはそのままガイドワイヤが挿入できる。

3.ガイドワイヤ

本品は、血管を確保したプラスチックカニューラ針又は金属穿刺針に挿入して血管を確保する。カニューラを抜去後、ダイレータを挿入する。

4.ダイレータ

本品は、ガイドワイヤに沿ってカテーテル挿入路の拡張に用いた後、抜去する。

5.ドレープ

無菌術野の確保とベットシート等の汚れ防止用。

6.固定具(フィクスチャー、フィクスチャーウイング)

カテーテルの皮膚固定用。

＜原材料＞

カテーテル:ウレタン樹脂

【使用目的又は効果】

医薬品の注入、採血、輸血及び圧測定用。

本品は、医薬品の注入、採血、輸血及び圧測定等を行うことを目的とした静脈留置用カテーテルとそのカテーテルを経皮的に血管内に留置する器具を揃えたセットである。

なお、カテーテル表面にはウロキナーゼを固定化してあるため、抗血栓性を有する。

本品は滅菌済みであり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

【使用方法等】

1.カニューラタイプ

(1)常法によりプラスチックカニューラ針(ピールオフタイプ)で血管を穿刺する。血液の逆流を確認し、注射筒を保持し、プラスチックカニューラ(以下、カニューラ)のみ血管内へ進めて留置し、内針(金属穿刺針)を抜去する。

〔注意〕プラスチックカニューラ針(ピールオフタイプ)の穿刺にあたっては、カニューラの中で金属穿刺針を前後に動かさないようにすること。また、金属穿刺針をカニューラに再挿入しないこと。[カニューラが破損し、破断片が体内に引き込まれ、回収不能のおそれがあるため。]

(2)カテーテル先端を留置したカニューラに挿入し、深度目盛(デプスマーク)を確認しながらスリーブあるいは保護シースを使用してカテーテルを、血管内へ挿入する。

(3)カテーテルが目的の位置に留置されたことを確認し、カニューラを血管より引き抜く。

- 1.カテーテルがズレないように注意し、カニューラを穿刺部位から引き抜く。
- 2.カニューラの把手を左右に広げるようにして分割し、カテーテルより取り除く。

〔注意〕一方の把手を押さえて、他方の把手のみ引っ張って分割しないこと。勢いよく分割しないこと。[カニューラがラインに沿って分割されないことがある。]

(4)カテーテルを留置後、カテーテル内の空気を除去し、カテーテル内腔を生理食塩液又はヘパリン加生理食塩液でフラッシュする。

(5)輸液回路に接続し、注入を開始する。


(6)カテーテルをフィクスチャーウイング及びフィクスチャーで皮膚に固定する。また縫合糸あるいはテープで固定することもできる。

(7)カテーテルをフィクスチャーウイング及びフィクスチャーで固定する場合は図1以下を参照する。

- 1.カテーテル固定に適切と思われる位置にフィクスチャーウイングを取り付ける。フィクスチャーウイングの内腔内に確実にカテーテルをはめ込まないとカテーテルが閉塞したり、固定が不十分になることがある。

〔注意〕フィクスチャーウイングをカテーテルに取り付ける前にカテーテル表面及びフィクスチャーウイング内面に付着している水分(ヘパリン加生理食塩液、消毒液等)を完全に除去すること。[水分がカテーテル表面とフィクスチャーウイング間に残留すると、留置中にカテーテルが抜ける原因となるため。]

- 2.図2のようにフィクスチャーをフィクスチャーウイングにかぶせ、指で上下からはさんで完全にはめ込む。フィクスチャーは正しい位置(フィクスチャーウイングのウイング部にフィクスチャーの凸凹がぴったりはまる位置)に装着すること。
- 3.フィクスチャーウイングを縫合糸で皮膚に固定する(図3)。

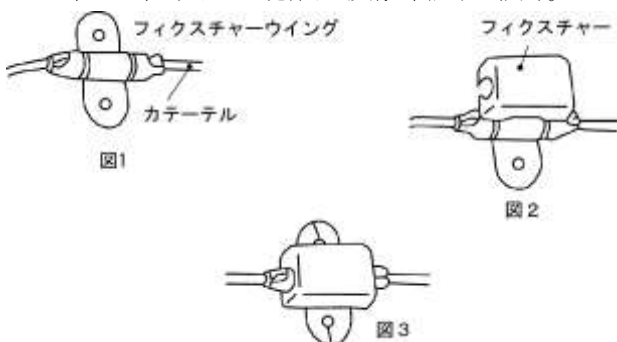

2.セルジンガータイプ

(1)常法によりプラスチックカニューラ針又は金属穿刺針で血管を穿刺する。血液の逆流を確認し、注射筒を保持し、カニューラのみ血管内へ進めて留置し、内針を抜去する。

(2)留置したカニューラにガイドワイヤを通し、血管内へ挿入する。また、金属穿刺針の場合、血液の逆流を確認し、そのままガイドワイヤを挿入できる。

(3)カニューラを取り除き、ガイドワイヤに沿ってダイレクタを血管内へ挿入する(あらかじめ刺入部に小切開を加えておくこと挿入が容易になる)。

(4)ダイレクタが血管内へ挿入されたことを確認し、ダイレクタを取り除き、ガイドワイヤのみを残す。

(5)残ったガイドワイヤにカテーテルを通し、深度目盛(デプスマーク)を確認しながら血管内へ挿入する。

(6)カテーテルを留置後、カテーテル内の空気を除去し、カテーテル内腔を生理食塩液又はヘパリン加生理食塩液でフラッシュする。

(7)輸液回路に接続し、注入を開始する。

(8)カテーテルをフィクスチャーウイング及びフィクスチャーで皮膚に固定(図1以下参照)する。また縫合糸あるいはテープで固定することもできる。

3.カテーテル抜去

カテーテル抜去の際は、以下の点に注意し、定められた手順に従い実施すること。

(1)抜去するときは刺入部位を心臓から低くする。空気塞栓を防止するために、仰臥位またはトレンデレンブルグ体位を推奨する。

(2)ドレッシング材を取り除く。

(3)カテーテルを切断しないように注意しながら、固定具(フィクスチャー、フィクスチャーウイング)の縫合箇所を抜糸する。

(4)カテーテルをゆっくりと抜去する。確実に止血されていることを確認し、密閉性の高いドレッシング材を貼付する(24時間程度)

(5)抜去手順を記録する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

●カテーテル、プラスチックカニューラ針等血管刺入箇所には、直接手を触れないこと。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

●ガイドワイヤ挿入時に、無理な力をかけないこと。また、挿入操作時にガイドワイヤを前後させると、ガイドワイヤ先端付近で絡まったり結び目ができる可能性があるため、注意して取り扱うこと。[無理な力による破断、挿入操作時による絡まりや結び目でガイドワイヤが抜去不能となり、外科的措置が必要となるおそれがあるため。]

●カテーテルを右心房又は右心室に挿入あるいは留置しないこと。また、ガイドワイヤについても、右心室に挿入しないこと。[不整脈や心タンポナーデ等が発生させるおそれがあるため。]

●カテーテルやガイドワイヤの挿入はエックス線撮影下で行うことを推奨する。

●本品に注入器を接続して使用する際は、事前に接続部から薬液が漏出ししないことを確認すること。

●本品を注入器に接続する際に、注入器の操作方法の通り正しく接続できない注入器には使用しないこと。

●カテーテルが折れ曲がらない部位で固定すること。

●カテーテルの皮膚固定部を支点として折れ曲げなどのストレスや引張り力を与えないようカテーテル全長(刺入部～アダプタ下部)をドレッシング等で患者の体に固定すること。

●固定具(フィクスチャー、フィクスチャーウイング)を使用せずに直接縫合糸でカテーテルを固定する場合、カテーテルに無理な引張り力がかからないようにすること。[固定部でカテーテルが破断してカテーテルの先端部が体内に遺残するおそれがあるため。]

●カテーテルが折れ曲がったり、縫合糸で強くしばって圧迫したカテーテルでは、輸液が一定の速度で流入しないことがあるので、輸液の流入速度を定期的に確認すること。

- すべての操作において、穿刺具、メス、ハサミ、縫合針等をカテーテルに接触させないこと。[傷付けて液漏れが生じるおそれがあるため。]
 - カテーテルを固定している縫合糸等の緩みにより、カテーテルが自然抜去することがあるので、定期的に固定具合を確認すること。
 - カテーテル感染、静脈血栓症等の症状が生じたときは、カテーテルを速やかに抜去すること。
 - カテーテルの留置中にカテーテル内に逆流した血液の凝固塊及び血栓が形成されるおそれがあるので、1日に1回カテーテル内腔をフラッシュし、ヘパリンロックすること。
 - 感染経路となりやすいカテーテル刺入部及び回路接続部は十分に消毒し(水溶性のポビドンヨード製剤の使用を推奨する。)感染に注意すること。
 - ドレッシング材の貼付に際しては、カテーテルに引張りのテンションをかけないように注意すること。
 - 全操作中に、鉗子等でカテーテルを直接挟まないこと。[傷付けて液漏れが生じるおそれがあるため。]
 - カテーテルの皮膚固定には同梱している固定具(フィクスチャー及びフィクスチャーウイング)の使用を推奨する。直接皮膚に縫合糸で固定する場合には、縫合糸で強く縛り過ぎると、カテーテルが破断するおそれがあるので注意すること。
 - 造影剤の高圧注入投与は行わないこと。[液漏れ、カテーテルの破断のおそれがあるため。]
 - ガイドワイヤ操作時に、ガイドワイヤを鉗子等で挟まないこと。[鉗子等で挟むことで、ガイドワイヤがキンク、コイルずれ、破断の可能性があるので。]
- ※●本品はMR Safe であり、一般的なMR検査による影響はない。

2. 不具合・有害事象

カテーテルの留置操作中あるいは留置中に、以下の不具合・有害事象がまれにあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

重大な不具合事象

カテーテル離断

重大な有害事象

気胸、血胸、皮下血腫、縦隔血腫、血管穿孔、動脈誤穿刺、神経損傷、血栓症、空気塞栓症、カテーテル塞栓、心タンポナーデ、不整脈、血管損傷、静脈炎、菌血症、敗血症等、Extravasation of fluids(高張液の血管外滲出)、自己抜去によるカテーテルの抜けまたは破断等

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

※製造販売業者

※カーディナルヘルス株式会社

カスタマーサポートセンター:0120-917-205