


## 製品パッケージ変更のご案内

# セイラム サンプ チューブ


この度、カーディナルヘルス（Cardinal Health）へのブランド変更にともない、弊社が販売するコヴィディエン製品につきまして、製品パッケージを変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 1 次包装

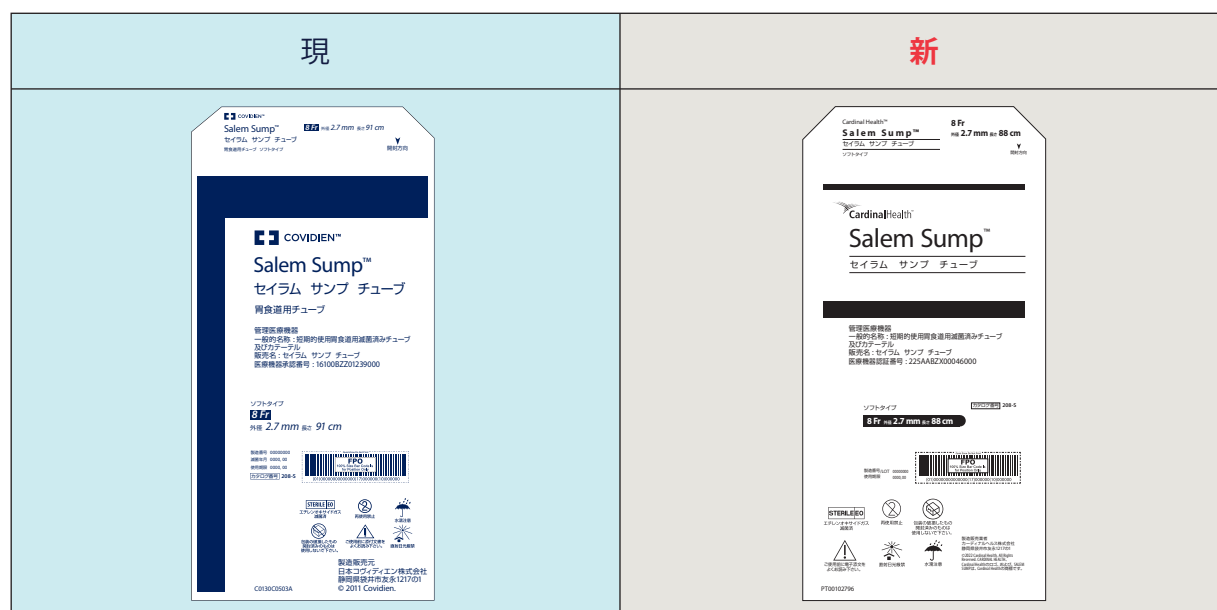

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

### 2 次包装

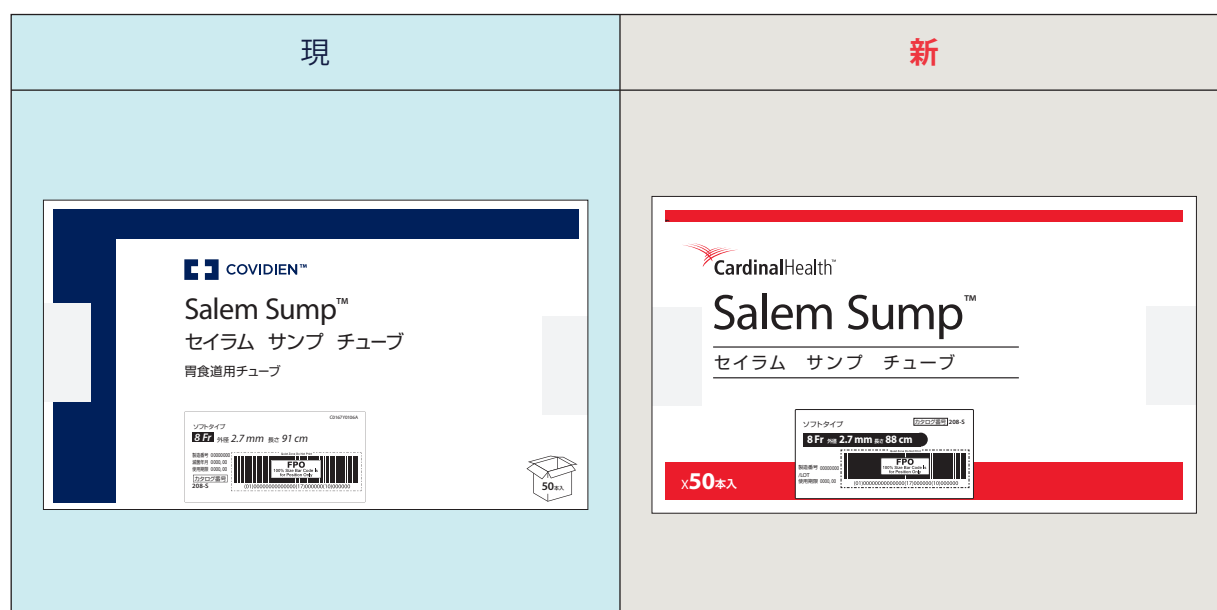

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

## 対象カタログ番号

カタログ番号	現 JAN コード	新 JAN コード
208-S	4987578013471	変更対象外
210	4987578013495	変更対象外
210-S	4987578013518	変更対象外
212	4987578013570	変更対象外
212-S	4987578013594	変更対象外
214	4987578013631	変更対象外
214-S	4987578013655	変更対象外
216	4987578013693	変更対象外
216-S	4987578013716	変更対象外
218	4987578013754	変更対象外
218-S	4987578013778	変更対象外
220ES	4987578080312	変更対象外
222ES	4987578080336	変更対象外
224ES	4987578080350	変更対象外
226ES	4987578080374	変更対象外
228ES	4987578080398	変更対象外
3201-08-S	4987578013921	変更対象外
3201-10	4987578013945	変更対象外
3201-10-S	4987578013969	変更対象外
3201-12	4987578013983	変更対象外

カタログ番号	現 JAN コード	新 JAN コード
3201-12-S	4987578014003	変更対象外
3201-14	4987578014027	変更対象外
3201-14-S	4987578014041	変更対象外
3201-16	4987578014065	変更対象外
3201-16-S	4987578014089	変更対象外
3201-18	4987578014102	変更対象外
3201-18-S	4987578014126	変更対象外

## 製品情報

クラス分類：Ⅱ 管理医療機器  
 一般的名称：短期的使用胃食道用滅菌済みチューブ及びカテーテル  
 販売名：セイラム サンプ チューブ  
 医療機器認証番号：225AABZX00046000

## お問い合わせ先

日本コヴィディエン株式会社  
 Tel：0120-917-205