


製品パッケージ変更のご案内

PICC キット II


この度、カーディナルヘルス (Cardinal Health) へのブランド変更にもない、弊社が販売するコヴィディエン製品につきまして、製品パッケージを変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1 次包装

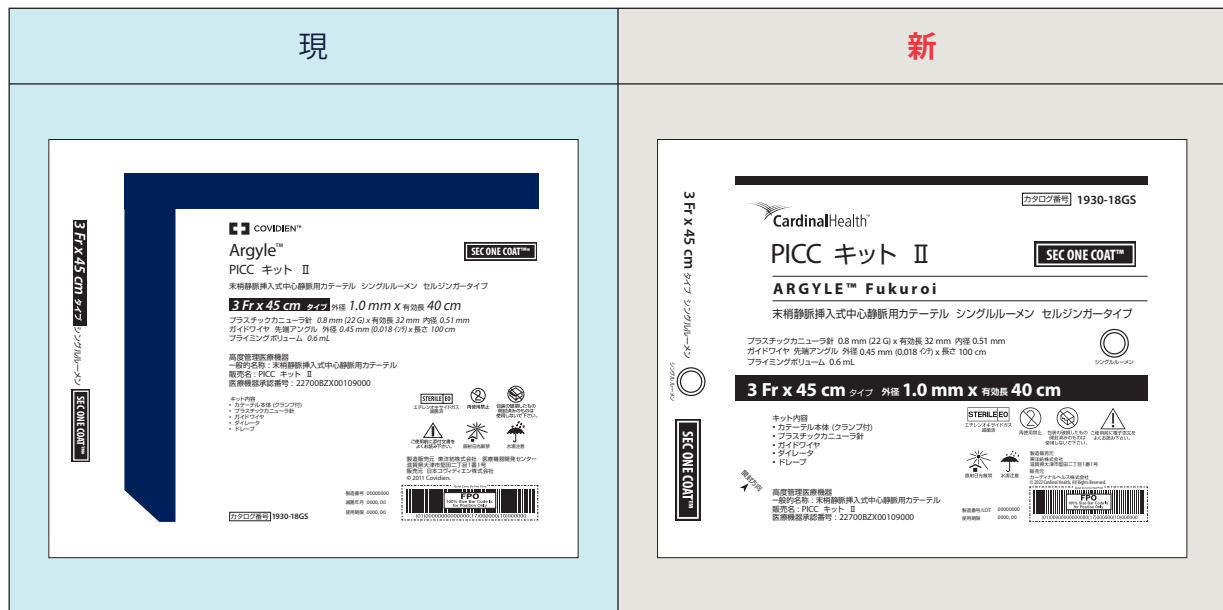

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

2 次包装

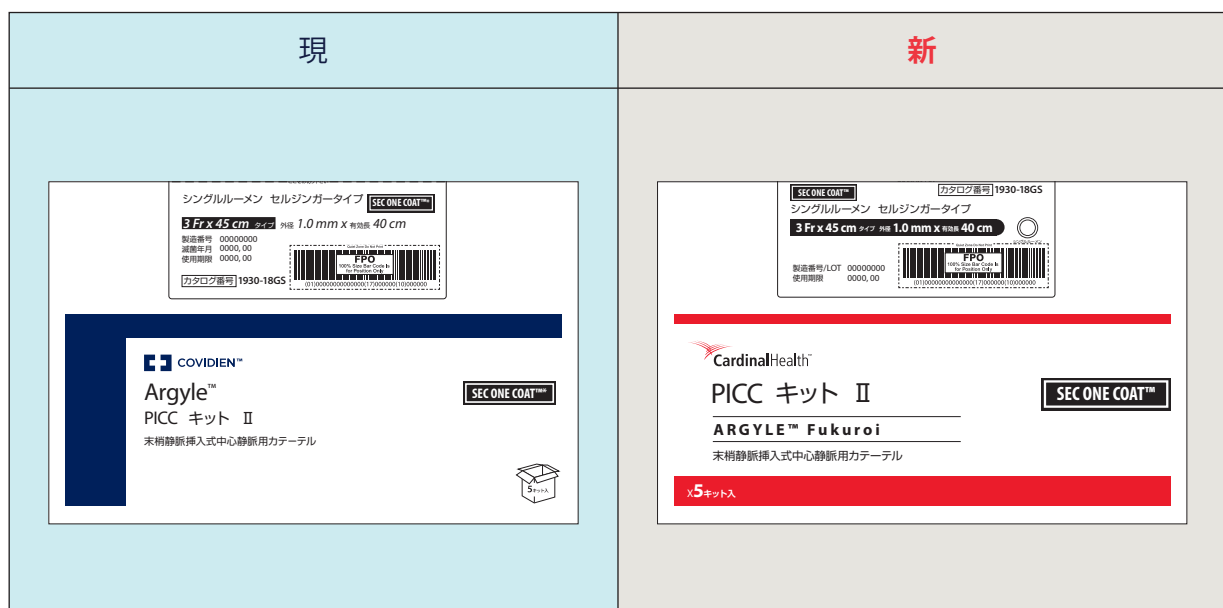

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

対象カタログ番号

カタログ番号	現 JAN コード	新 JAN コード
1930-18GS	4965838907111	変更対象外
1930-23GS	4965838907135	変更対象外
1940-18GS	4965838907128	変更対象外
1940-23GS	4965838907142	変更対象外
1945-18WGS	4965838907159	変更対象外
1945-23WGS	4965838907166	変更対象外

製品情報

クラス分類：IV 高度管理医療機器
一般的名称：末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル
販売名：PICC キットII
医療機器承認番号：22700BZX00109000
製造販売業者：東洋紡株式会社

お問い合わせ先

日本コヴィディエン株式会社
Tel：0120-917-205