


## 製品パッケージ変更のご案内

# トロツカー カテーテル

この度、カーディナルヘルス (Cardinal Health) へのブランド変更にもない、弊社が販売するコヴィディエン製品につきまして、製品パッケージを変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 1 次包装

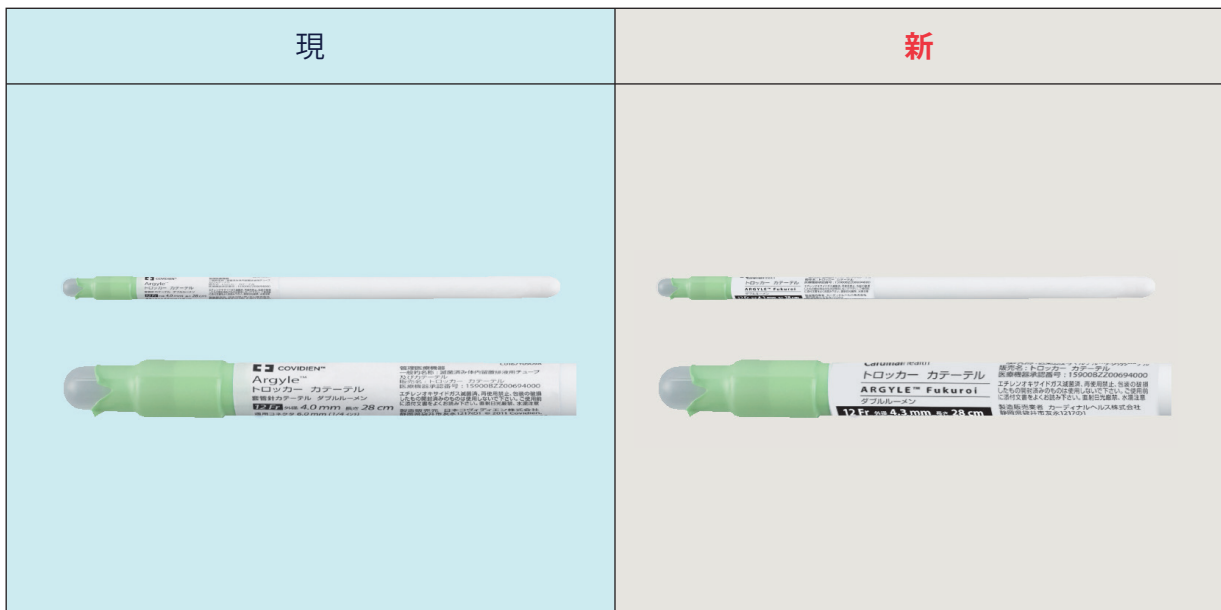

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

### 2 次包装



※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

## 対象カタログ番号

カタログ番号	現 JAN コード	新 JAN コード
5610-08	4987578014447	変更対象外
5610-10	4987578014461	変更対象外
5610-12	4987578014485	変更対象外
5610-14	4987578014508	変更対象外
5610-16	4987578014522	変更対象外
5610-18	4987578014546	変更対象外
5610-20	4987578014560	変更対象外
5610-22	4987578014584	変更対象外
5610-24	4987578014607	変更対象外
5610-28	4987578014621	変更対象外
5610-32	4987578014645	変更対象外
5610E12W	4987578080435	変更対象外
5610E14W	4987578080459	変更対象外
5610E16W	4987578080473	変更対象外
5610E18W	4987578080497	変更対象外
5610E20W	4987578080510	変更対象外
5610E22W	4987578080534	変更対象外
5610E24W	4987578080558	変更対象外
5610E28W	4987578080572	変更対象外

## 製品情報

クラス分類：Ⅲ 高度管理医療機器  
 一般的名称：医薬品投与マルチルーメンカテーテル  
 販売名：トロッカー カテーテル  
 医療機器承認番号：15900BZZ00694000

## お問い合わせ先

日本コヴィディエン株式会社  
 Tel：0120-917-205