


## 製品パッケージ変更のご案内

# CV カテーテル セルジンガー キット


この度、カーディナルヘルス (Cardinal Health) へのブランド変更にともない、弊社が販売するコヴィディエン製品につきまして、製品パッケージを変更する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。しばらくの間、新仕様品と旧仕様品が混在いたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 1 次包装

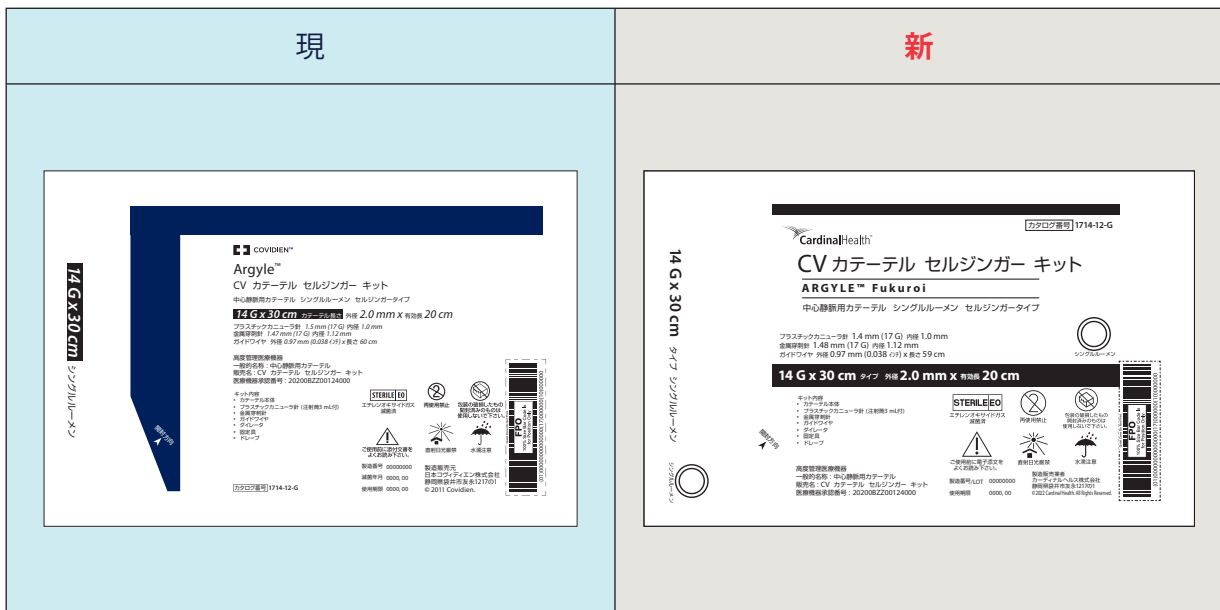

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

### 2 次包装

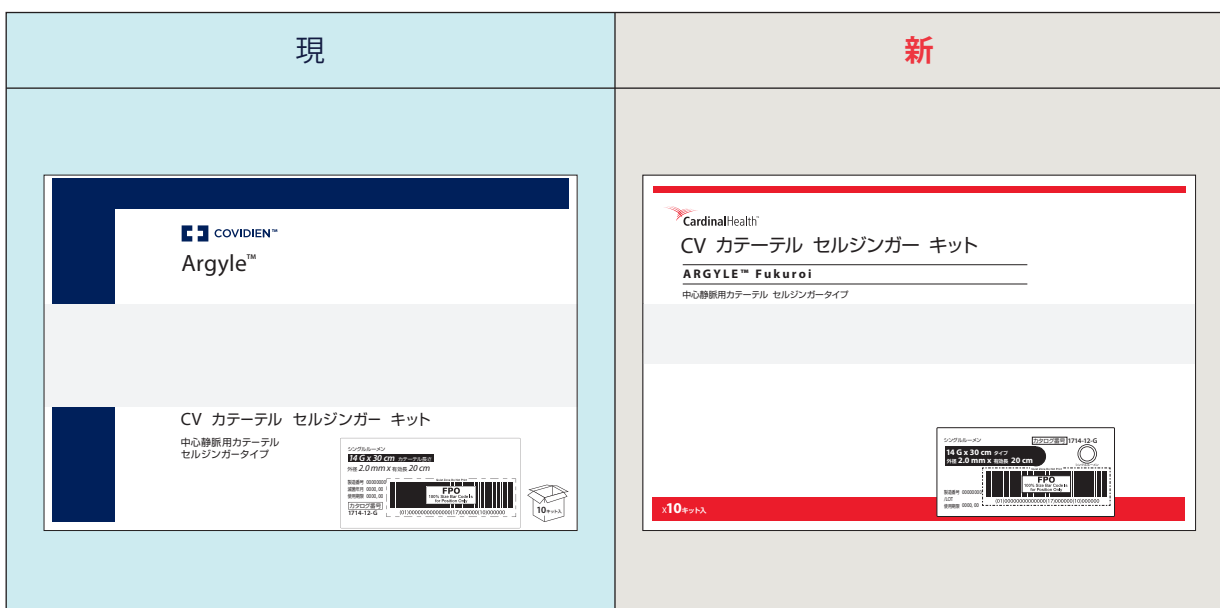

※製品およびパッケージのサイズに変更はございません。

## 対象カタログ番号

カタログ番号	現 JAN コード	新 JAN コード
1712-08TBG	4987578029793	変更対象外
1712-08WBG	4987578003014	変更対象外
1712-12TBG	4987578003335	変更対象外
1712-12WBG	4987578003038	変更対象外
1712-20TBG	4987578029779	変更対象外
1712-20WBG	4987578003052	変更対象外
1714-08WBG	4987578003076	変更対象外
1714-12-G	4987578001522	変更対象外
1714-12WBG	4987578003090	変更対象外
1714-20-G	4987578001546	変更対象外
1714-20WBG	4987578003113	変更対象外
1716-08-G	4987578001560	変更対象外
1716-08WBG	4987578003137	変更対象外
1716-12-G	4987578001584	変更対象外
1716-12WBG	4987578003151	変更対象外
1716-20-G	4987578001607	変更対象外
1716-20WBG	4987578003175	変更対象外
1718-08WBG	4987578003199	変更対象外
1718-12-G	4987578001645	変更対象外
1718-12WBG	4987578003212	変更対象外

カタログ番号	現 JAN コード	新 JAN コード
1718-20-G	4987578001669	変更対象外
1718-20WBG	4987578003236	変更対象外
1720-12-G	4987578001706	変更対象外

## 製品情報

クラス分類：IV 高度管理医療機器  
 一般的名称：中心静脈用カテーテル  
 販売名：CV カテーテル セルジンガー キット  
 医療機器承認番号：20200BZZ00124000

## お問い合わせ先

日本コヴィディエン株式会社  
 Tel：0120-917-205